


## Bemerkungsfeld in den Röhrendaten

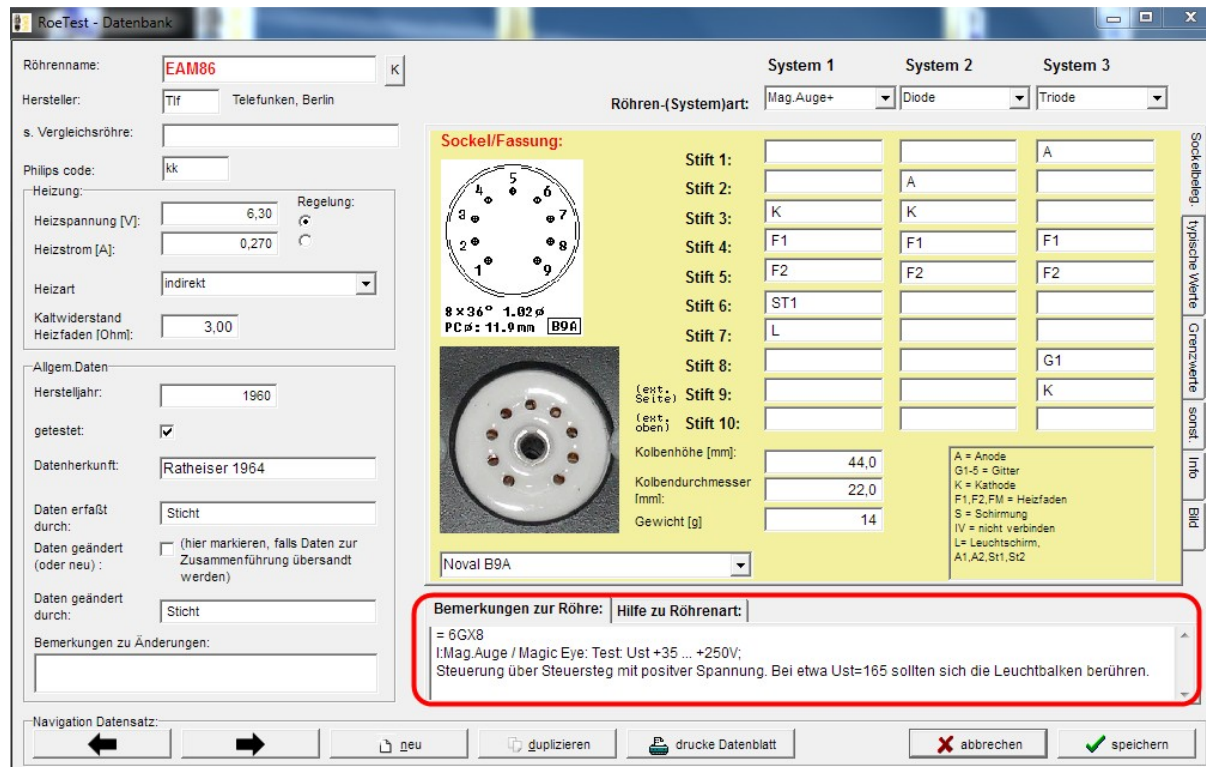

Im Bemerkungsfeld können Angaben zur Röhre gemacht werden, für welche kein eigenes Feld vorgesehen ist. Die Angaben sollen nach folgenden Regeln erfolgen:


An erster Stelle stehen Vergleichsröhren, Beispiel: = EF80, AZ12, EM34

>Es können beliebige Angaben gemacht werden. Dabei gibt es folgende Kürzel (Beispiel):

V: Senderöhre - Verwendungszweck

I: Info, Prüfanweisung

alles nach einem I: wird im Meldfenster in grüner Schrift angezeigt

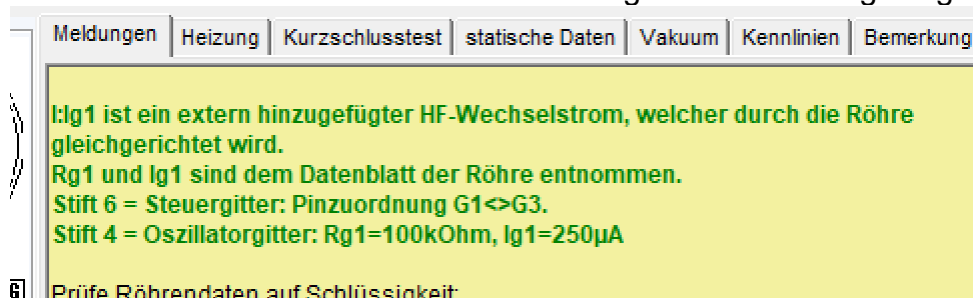

und wird im manuellen Modus angezeigt, und auch im manuellen Modus mit Vorwiderstand:

8	I G2+G4 [mA]	3,200
9	Uh [V]	1,4
10	Ih [A]	0,05

+  
 -

Ig1 ist ein extern hinzugefügter HF-Wechselstrom, welcher durch die Röhre gleichgerichtet wird.  
 Da1 und Ia1 sind dem Datenblatt der Röhre entnommen.

Für längere Prüfanweisungen und Erklärungen kann eine Dateianlage zum Datensatz hinzugefügt werden (remarks.pdf)  
 → siehe „Datenbank – Röhrendaten (mit Bedienung der Datenbanken)“